

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0218.6—1995

转 鼓 贴 标 机

1995-12-22 发布

1996-10-01 实施

国家医药管理局 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了转鼓贴标机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于转鼓贴标机(以下简称贴标机)。


2 引用标准

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 2638—81 玻璃药瓶
- GB 2639—90 玻璃输液瓶
- GB 5226—85 机床电气设备通用技术条件
- GB 7311—87 包装机械型号编制方法
- GB/T 13306—91 标牌
- GB/T 13384—92 机电产品包装通用技术条件
- YY 0076—92 金属制件的镀层分类技术条件

3 产品分类

3.1 型号表示方法

型号标记应符合 GB 7311 的规定。

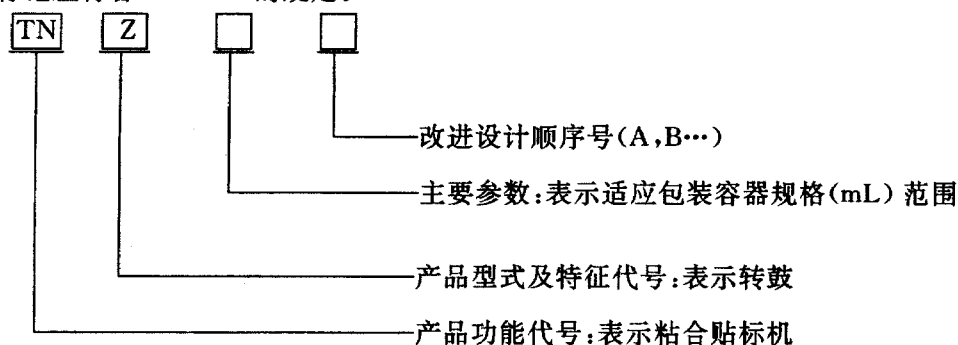

标记示例:TNZ 20/1 000 型

表示适应包装容器规格(mL)范围 20~1 000 的转鼓粘鼓贴标机。

- 3.2 使用电源条件:电压:AC 380V±10%、频率:50 Hz±2%。
- 3.3 功率:应不大于 2.5 kW。
- 3.4 生产能力:根据容器规格不同,可在表 1 范围内调节。