

# YY

## 中华人民共和国行业标准

YY 0025—90

---

### 真 空 浓 缩 罐

1990-11-15 发布

1991-04-01 实施

---

国家医药管理局 发布

# 中华人民共和国行业标准

YY 0025—90

## 真空浓缩罐

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了真空浓缩罐的型号及其基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。


本标准适用于真空度为 60 kPa 的真空浓缩罐(以下简称浓缩罐)。

### 2 引用标准

- GB 150 钢制压力容器
- GB 1226 一般压力表
- GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级
- ZBY 270 工业玻璃温度计和实验玻璃温度计
- JB 8 产品标牌
- JB 452 弹簧式安全阀技术条件
- JB 2536 压力容器油漆、包装、运输

### 3 型号及其基本参数

#### 3.1 型号

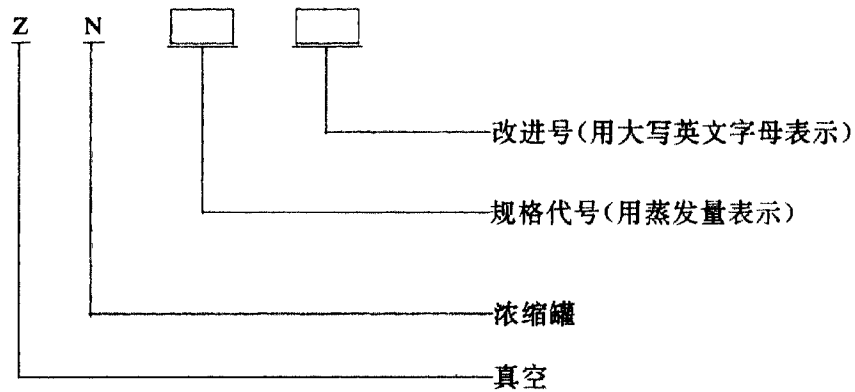

#### 3.2 基本参数应符合下表规定。

规格	20	40	60	80	100	130	160
蒸发量, kg/h	≥ 20	40	60	80	100	130	160
设备容积, L	50	100	200	300	500	700	1 000
设备内允许真空度, kPa	60						

国家医药管理局 1990-11-15 批准

1991-04-01 实施