

**YY**

# 中华人民共和国医药行业标准

YY 0131—93

---

## 口服液瓶撕拉铝盖

1993-07-19 发布

1993-12-01 实施

国家医药管理局 发布

口服液瓶撕拉铝盖

1 主题内容与适用范围

本标准规定了口服液瓶撕拉铝盖的产品分类、规格尺寸、技术要求、材料、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于口服液瓶撕拉铝盖。

2 引用标准

- GB 228 金属拉伸试验法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用连续批的检查)
- GB/T 3190 铝及铝合金加工产品的化学成分
- GB 4807 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准
- GB 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 5009.64 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法
- GB 5009.67 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法
- GB 6987.1~6987.21 铝及铝合金化学分析方法
- GB 8544 铝及铝合金带材
- GB 9681 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准
- GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准
- YY 0056 管制口服液瓶

3 产品分类

3.1 铝盖的型式分为A型、C型两种。其中A型盖适用于YY 0056管制口服液瓶中的A型和B型瓶。C型盖适用于YY 0056管制口服液瓶中的C型瓶(见附录A)。

3.2 A型铝盖规格尺寸应符合图1、表1规定。

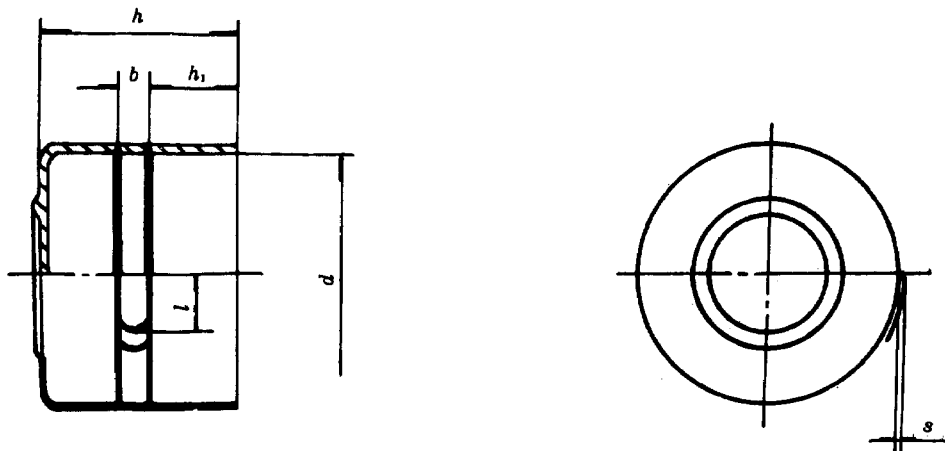


图1 A型