

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0230—1995

热 压 式 蒸 馏 水 机

1995-12-22发布

1996-10-01实施

国家医药管理局发布

前　　言

本标准是参照国外同类产品最新技术资料及进口同类产品的各项技术性能指标和质量要求,对原GB 11752—89 标准进行修订的。

与前版 GB 11752—89 重要技术内容改变情况的说明:

——4. 4 参照国外类似产品对奥氏体不锈钢材料含碳量的要求,提出“含碳量不大于 0.08%”。考虑到目前国内对此类不锈钢管材供应等实际问题,同意此项要求可以有一段过渡期;

——4. 4. 3 增加对保温材料的要求;

——4. 5. 3 增加“酸洗钝化或电抛光处理”的要求;

——4. 6 增加对蒸馏水机自动控制系统的要求;

——4. 7 增加对蒸馏水机自动控制系统可操作性,可靠性的要求;

——4. 8 增加电气安全性能要求;

——4. 9 增加蒸馏水机能耗指标;

——4. 10 增加对废气,废水的收集要求;

——4. 11. 1 增加蒸馏水机各种配管的外观要求。

本标准从生效之日起,同时代替 GB 11752—89。

本标准由国家医药管理局提出。

本标准由国家医药管理局天津制药机械检测中心归口。

本标准主要起草人:严巧娟、吴以强、傅新安。

中华人民共和国医药行业标准

YY 0230—1995

热压式蒸馏水机

1 范围

本标准规定了热压式蒸馏水机的型号与规格及基本参数,技术要求,试验方法,检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以蒸汽压缩方式实现热泵循环的热压式蒸馏水机(以下简称蒸馏水机)。

2 引用标准


下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—85 包装储运图示标志
- GB 3768—83 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB/T 4272—84 设备及管道保温技术通则
- GB 5226—85 机床电气设备通用技术条件
- GB 10111—88 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- GB/T 13306—91 标牌
- GB/T 13384—91 机电产品包装通用技术条件
- YY 0076—92 金属制件镀层分类技术条件
- YY/T 0216—95 制药机械产品型号编制方法
- HGJ 18—89 钢制化工容器制造技术要求
- JB 2880—81 钢制焊接常压容器 技术条件
- 《中华人民共和国药典》1995 版

3 型号与规格及基本参数

3.1 型号

应符合 YY/T 0216 的规定。

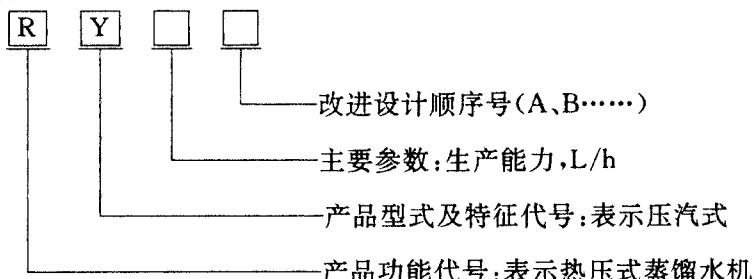

标记示例:

RY 500 A

第一次改进设计、每小时出水量 500 L 的热压式蒸馏水机。